




Datum: Ljubljana 07.06.2022

**Sistematično genomsko opredeljevanje in spremljanje epidemije SARS-CoV-2 v Sloveniji na
Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani
Rezultati testiranja 53 vzorcev odvzetih med 23. 05. 2022 in 29. 05. 2022**

V **triinsedemdeseto presejalno sekveniranje** virusnih različic SARS-CoV-2 z metodo določanja nukleotidnih zaporedij (sekveniranje) smo vključili 53 vzorcev (**71% vseh SARS-CoV-2 PCR-pozitivnih vzorcev na IMI**), ki so bili odvzeti med **23. 05. 2022 in 29. 05. 2022**. Izmed teh je bilo 56 % vzorcev iz Osrednjeslovenske regije, 11 % iz Gorenjske regije, 7 % iz Posavske regije, 5 % iz Jugovzhodne regije, po 4 % iz Obalno-kraške in Primorsko-notranjske regije ter po 2 % iz Goriške, Savinjske in Zasavske regije. Pet vzorcev je pripadalo osebam, ki imajo stalno prebivališče v tujini.

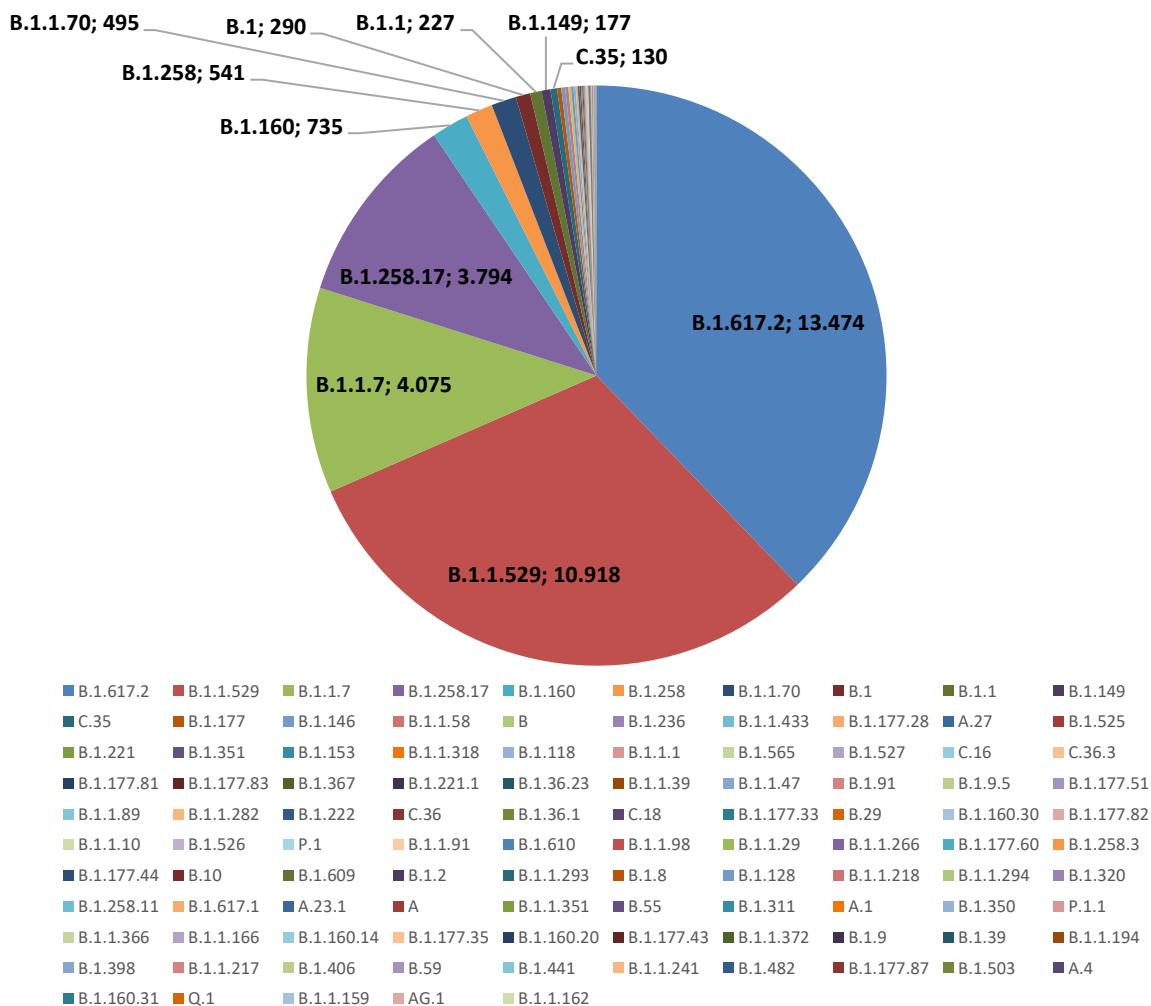

Slika 1. Razporeditev posameznih genetskih različic opredeljenih s sekveniranjem celotnega genoma iz vzorcev vključenih v presejalno sekveniranje.

Nadzor nad zaskrbljujočimi genetskimi različicami (VOC)

Beta - B.1.351 - Južnoafriška različica

Različica beta (501Y.V2 - B.1.351) vsebuje naslednje značilne mutacije: L18F, D80A, D215G, K417N, E484K, N501Y, D614G in A701V. **V triinsedemdesetem presejalnem obdobju različice beta nismo potrdili.** Skupno smo do sedaj dokazali različico beta pri 23 osebah, od katerih jih 21 nima jasne epidemiološke anamneze za potencialni neposredni vnos iz tujine. Ena oseba je pripravovala iz celinske Tanzanije in ena iz Zanzibarja.

Gama – P.1 - Brazilska različica


Različica gama (501Y.V3 – P.1) vsebuje naslednje značilne mutacije: L18F, T20N, P26S, D138Y R190S, K417T, E484K, N501Y, D614G, H655Y, T1027I, V1176F. **V triinsedemdesetem presejalnem obdobju različice gama nismo potrdili.** Različico gama smo doslej potrdili pri 3 osebah.

Delta - B.1.617.2 - Indijska različica


Različica delta (B.1.617.2) vsebuje naslednje značilne mutacije: T19R, L452R, T478K, D614G, D950N, P681R, del157/158. **V triinsedemdesetem presejalnem obdobju različice delta nismo potrdili.** Skupno smo do sedaj različico delta potrdili pri 13.474 osebah.

Omkron - B.1.1.529

Različica omikron (484A – B.1.1.529) vsebuje 26 aminokislinskih zamenjav, 3 delecije in 1 insercijo na beljakovini bodice S v primerjavi s prvotno različico (A67V, del69_70, T95I, G142D, del143_145, N211I, del211, ins214EPE, G339D, S371L, S373P, S375F, S477N, T478K, E484A, Q493R, G496S, Q498R, N501Y, Y505H, T547K, D614G, H655Y, N679K, P681H, D796Y, N856K, Q954H, N969K in L981F). **V triinsedemdesetem presejalnem obdobju smo različico omikron potrdili v vseh vzorcih.**

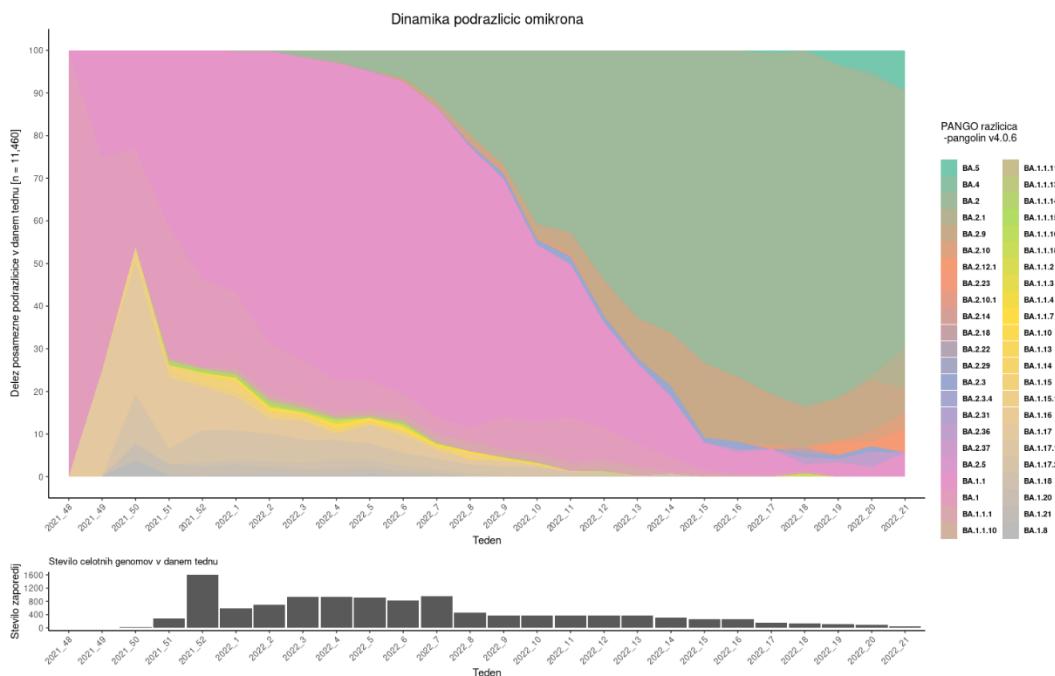

Slika 2. Delež posameznih podrazličic omikrona potrjenih v presejalnem testiranju.

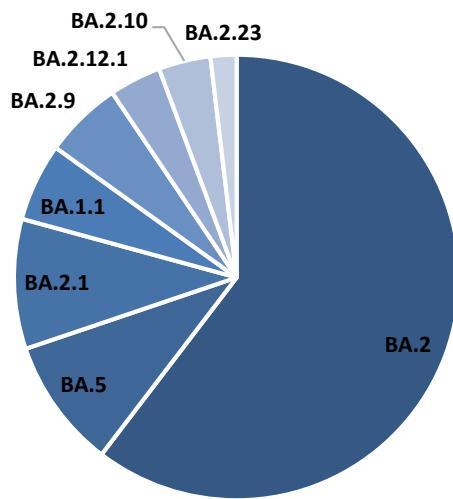

Slika 3. Razporeditev posameznih genetskih podrazličic omikrona dokazanih v triinsedemdesetem tednu, opredeljenih s sekveniranjem celotnega genoma.